


25-7-04

ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั่วไปให้สะอาด



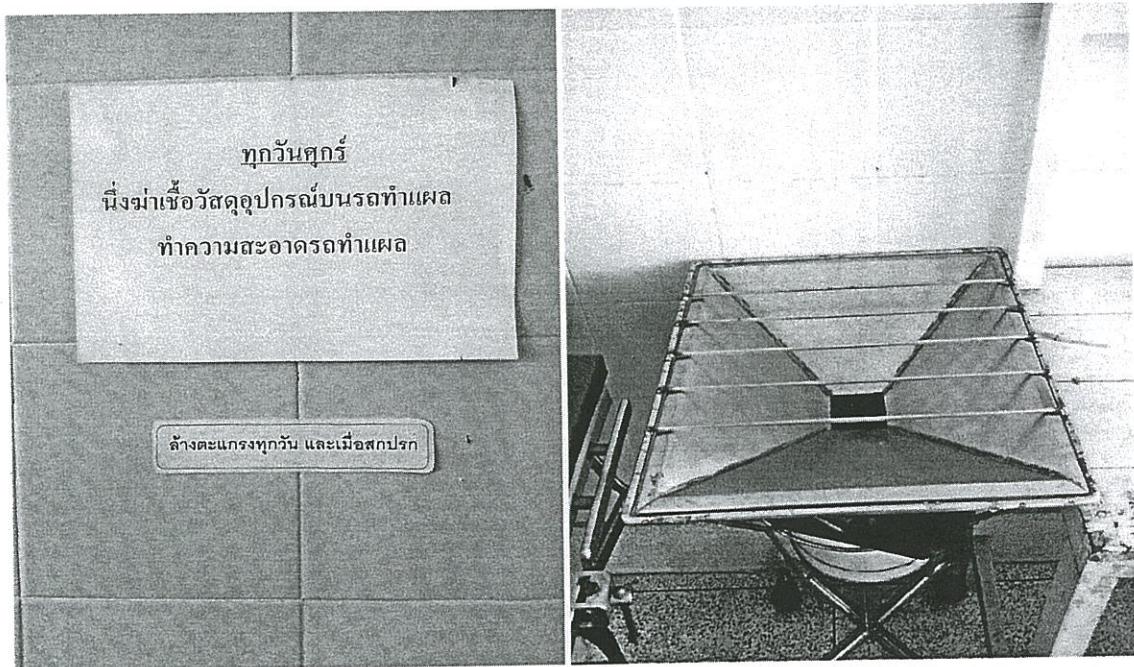

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ พท.บก.อภ.

ที่ ๐๐๓๕.๑๙/๔๓๗

โทร. ๑๓๗

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ใน พท.บก.อภ.

เรียน ผบก.อภ.(ผ่าน ผกก.ฝ่ายคลัง บก.อภ.)

๑. ผบช.รร.นรต.ได้ตรวจเยี่ยม พท.บก.อภ. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๒๕๕๖ และได้สั่งการให้ซื้อเตียงผู้ป่วย เครื่องซั่งน้ำหนักใหม่ เพาะสภาพค่อนข้างเก่า นอกจากนี้ให้จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ใน พท.บก.อภ. เพิ่มเข่น เครื่องวัดความดันโลหิต รถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องวัดไข้(ทกหน้าผาก) เป็นต้น

๒. พท.บก.อภ.ได้สำรวจวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้ ทั้งนี้ได้แนบภาพประกอบตามเอกสารแนบ

๒.๑ เตียงผู้ป่วย จำนวน ๒๑ เตียง (ปัจจุบันมีเตียงใหม่ ๑๘ เตียง, เตียงเก่า ๒๑ เตียง)

๒.๒ เครื่องซั่งน้ำหนักแบบเข็มพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ รถเข็นนั่งชนิดพับได้ จำนวน ๒ ตัว

๒.๔ แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ๑ แผ่น

๒.๕ เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก ๑ เครื่อง

๒.๖ เครื่องวัดความดันโลหิต ๑ เครื่อง

๓. จึงเห็นควร นำเรียน ผบช.รร.นรต. เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง ลูกพี่


( สุจารี บูรณภา )

สว.พท.บก.อภ.

เครื่องซั่งน้ำหนักแบบเข็มพร้อมที่วัดส่วนสูง  
แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

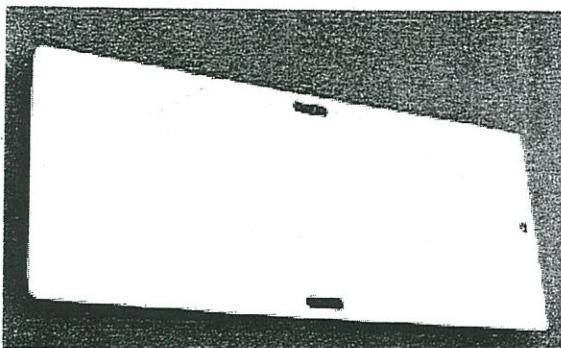


รถเข็นนั่งพับได้

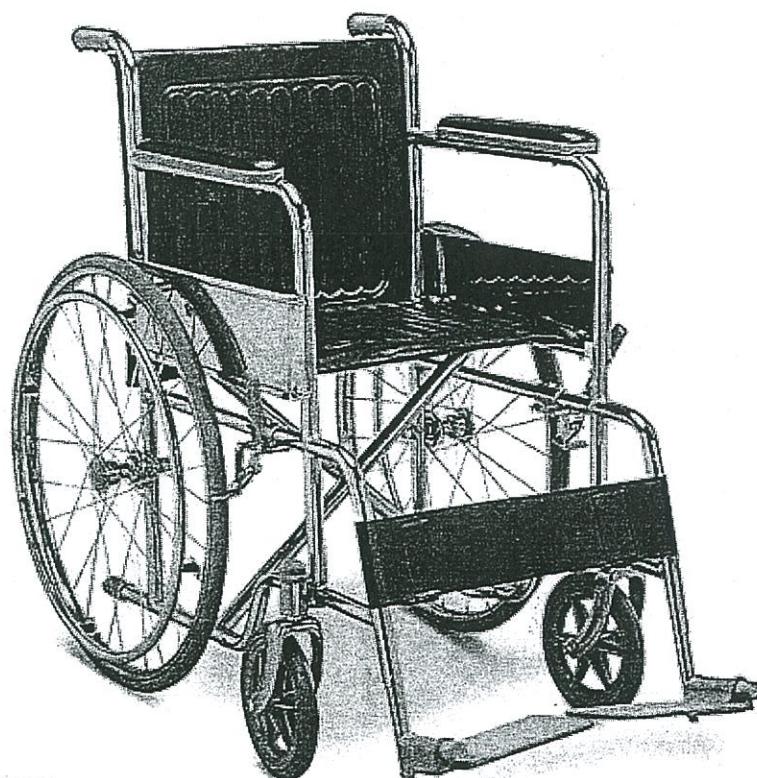


FS809

电瓶车床, 固定扶手, 固定脚托, 焊心前轮, 焊心后轮



เครื่องมือวัดไข้ทางหน้าผาก

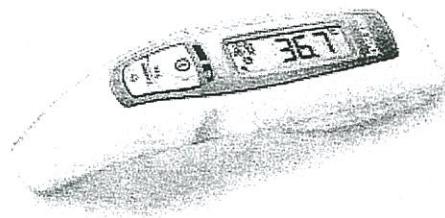

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

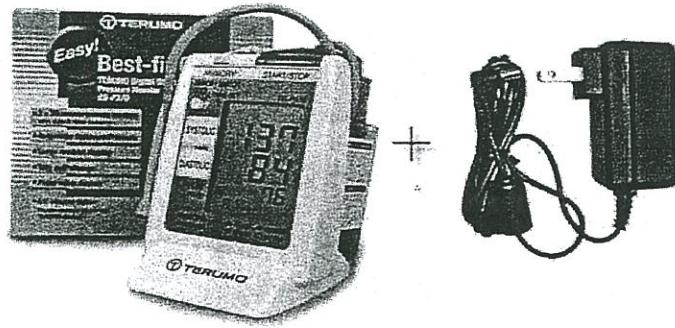

เตียงผู้ป่วยสามัญ แบบปรับมือ 3 ไก

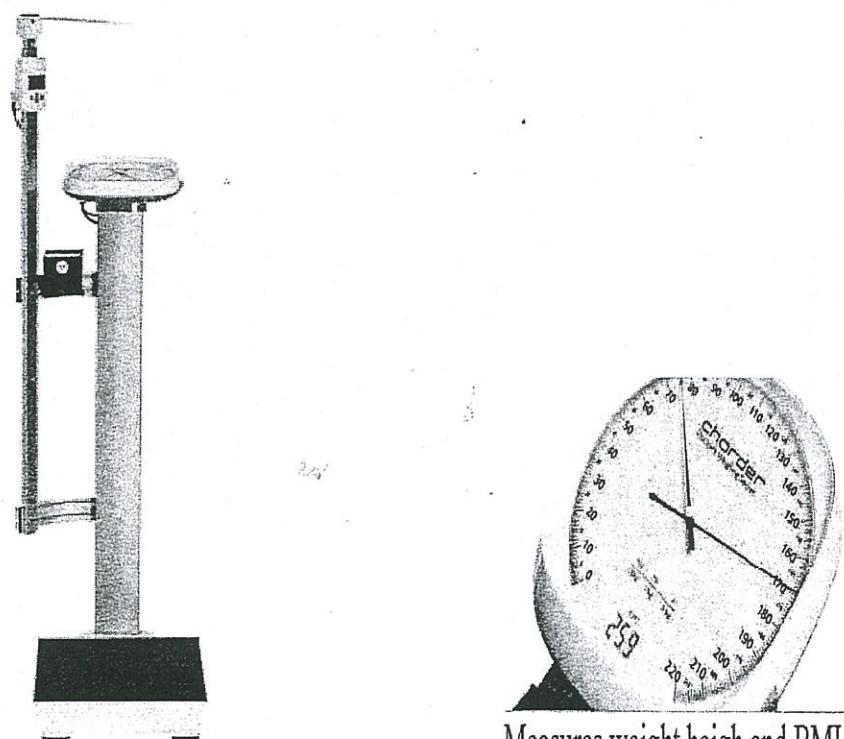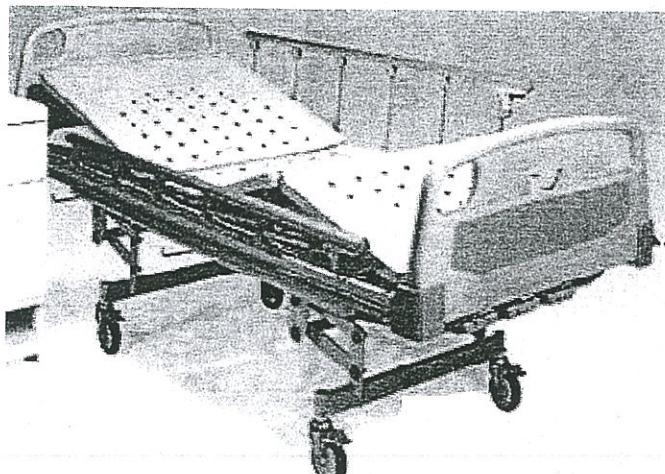

Measures weight, height and BMI.

เตียงที่จัดซื้อใหม่

